2022.06.27


- 1
- 2
- 3

1

	TK
	2022.06.27
	Brüel & Kjær/3050-A-040
	1200mm*1200mm*750mm 1.7T)THS3-500-4-J3
	1Y
	A B(2)




1

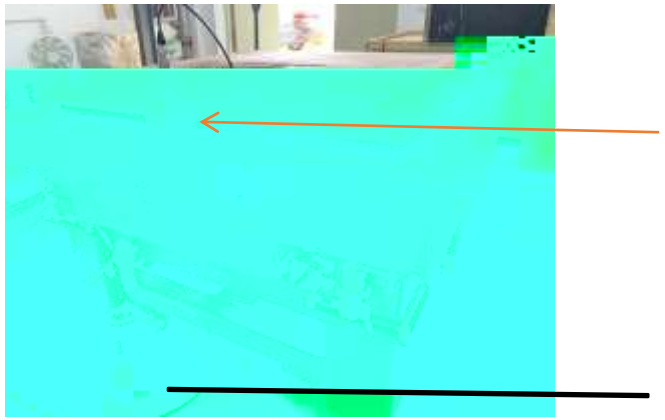

2

2 Y

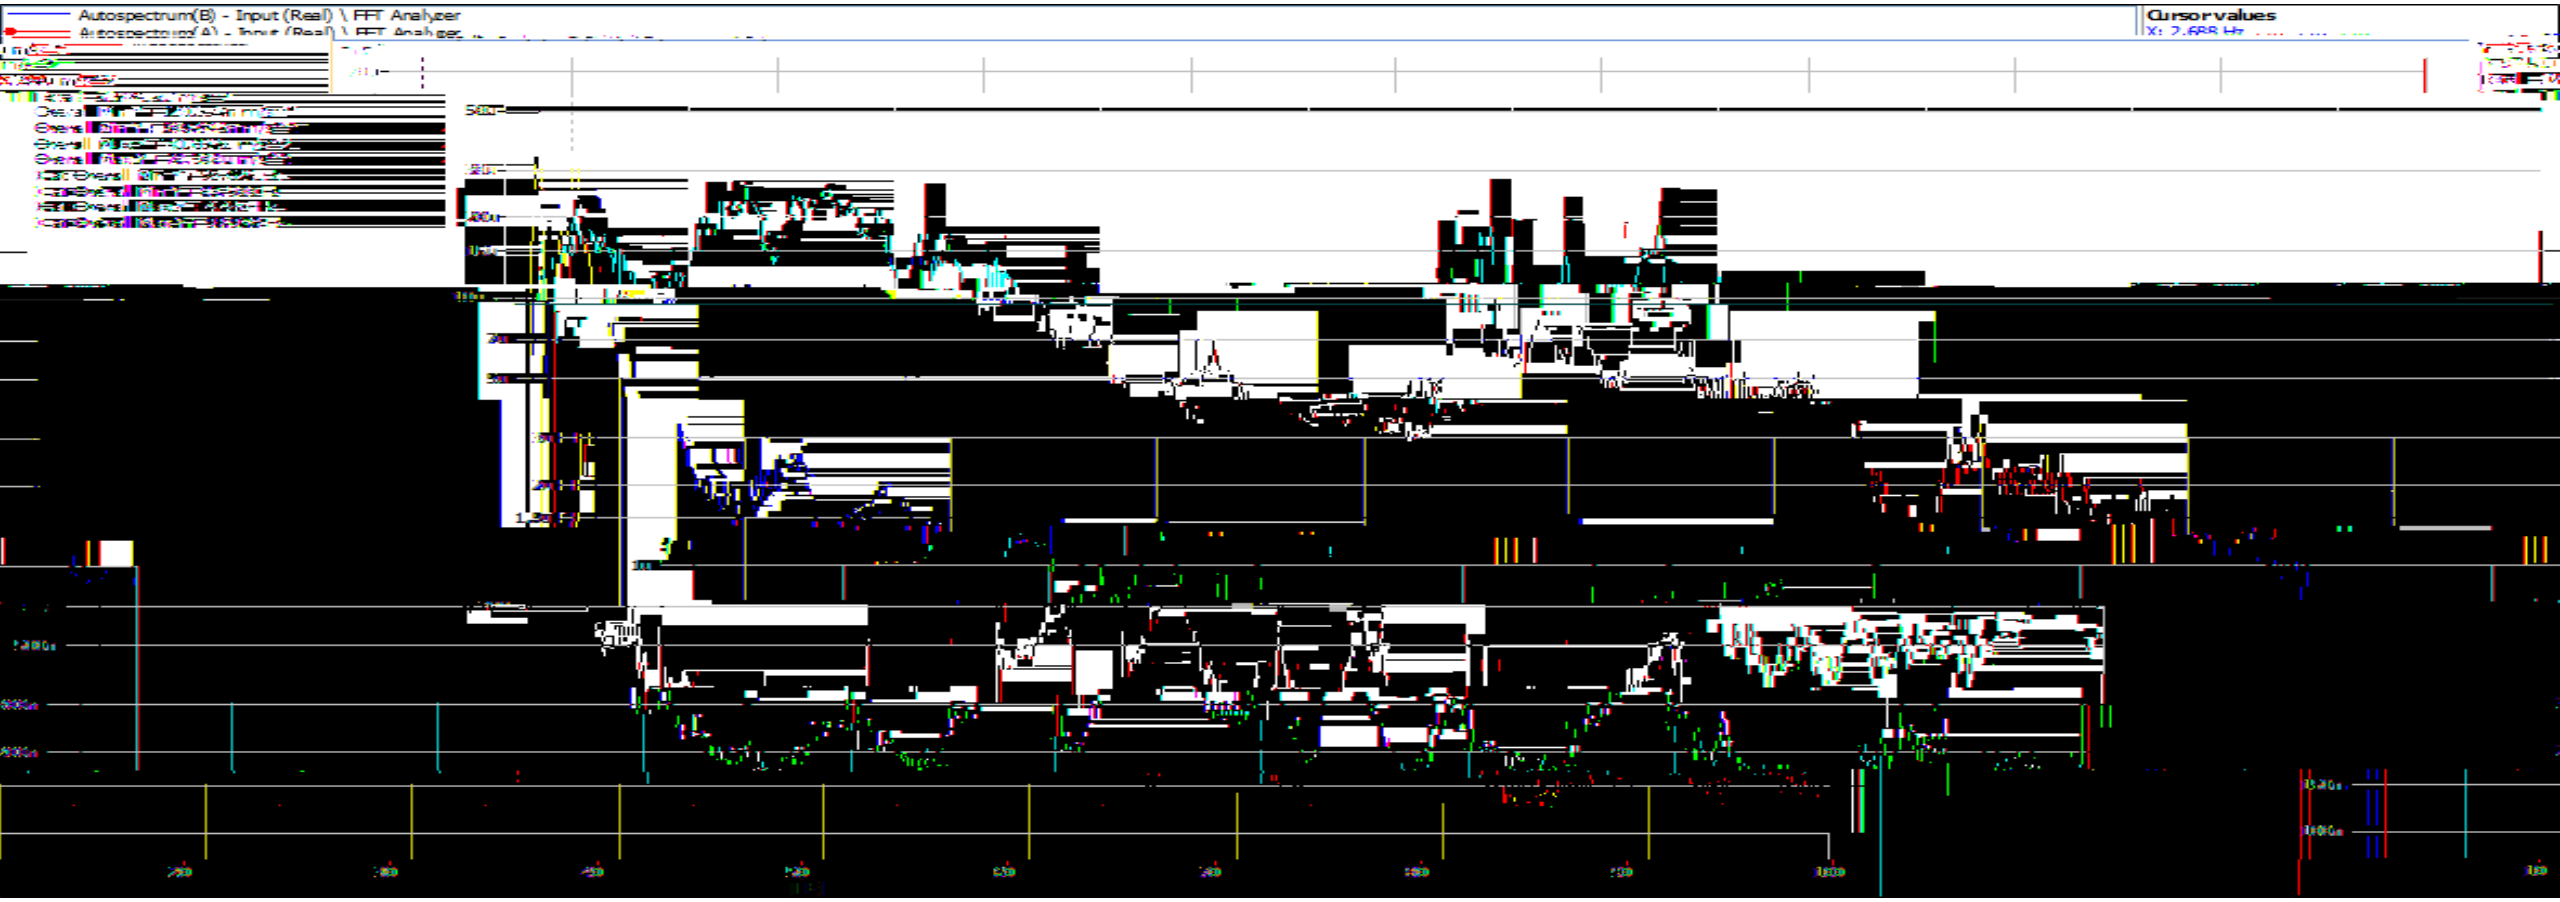


3 AB

3 Y




4 AB

5 Y

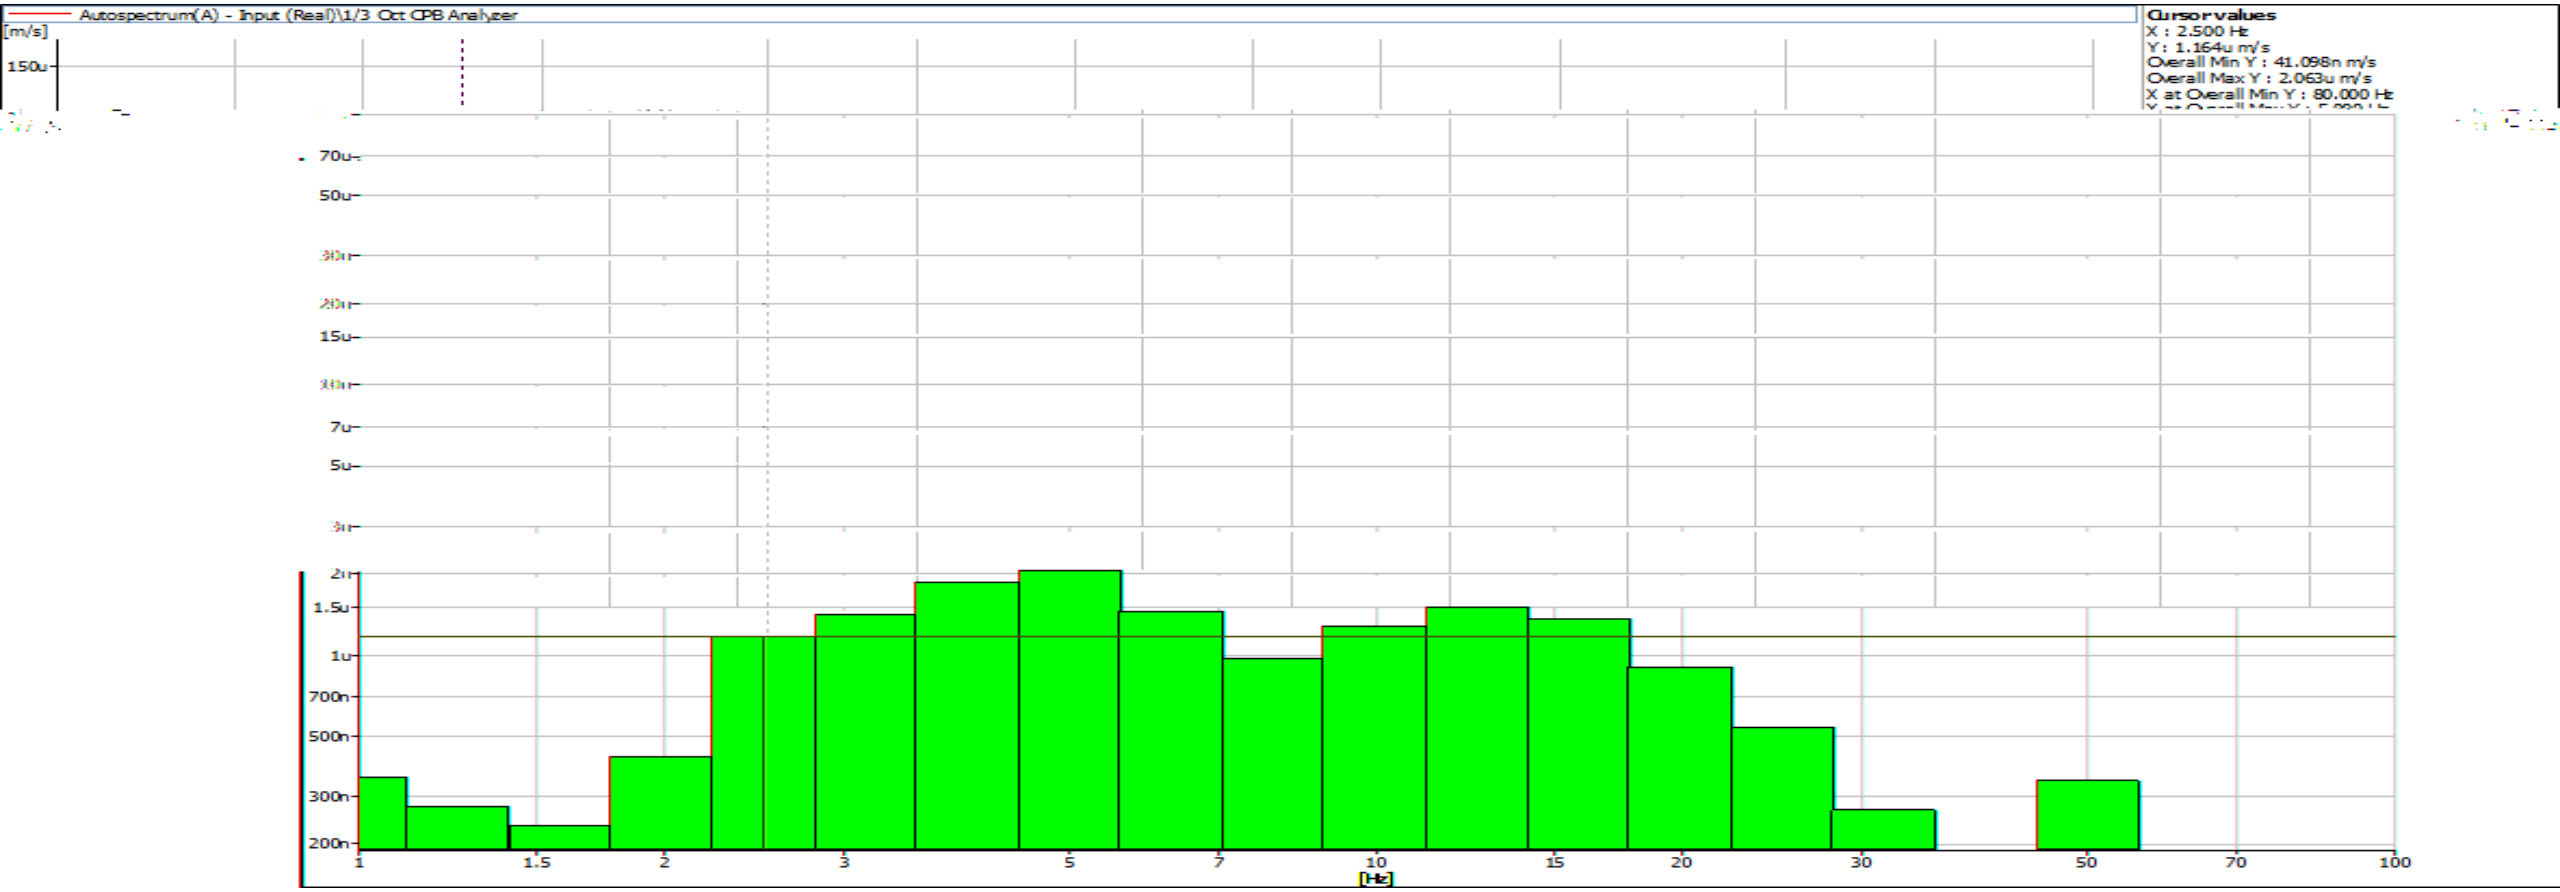
Autospectrum(A) - Input (Real)\1/3 Oct CPB Analyzer
[m/s]
150u
70u
50u
15u
7u
5u
1.5u
1u
700n
500n
300n
200n
1
1.5
2
3
5
7
10
15
20
30
50
70
100
[Hz]
Cursor values
X : 2.500 Hz
Y : 1.164u m/s
Overall Min Y : 41.098n m/s
Overall Max Y : 2.063u m/s
X at Overall Min Y : 80.000 Hz


5 A

6 Y

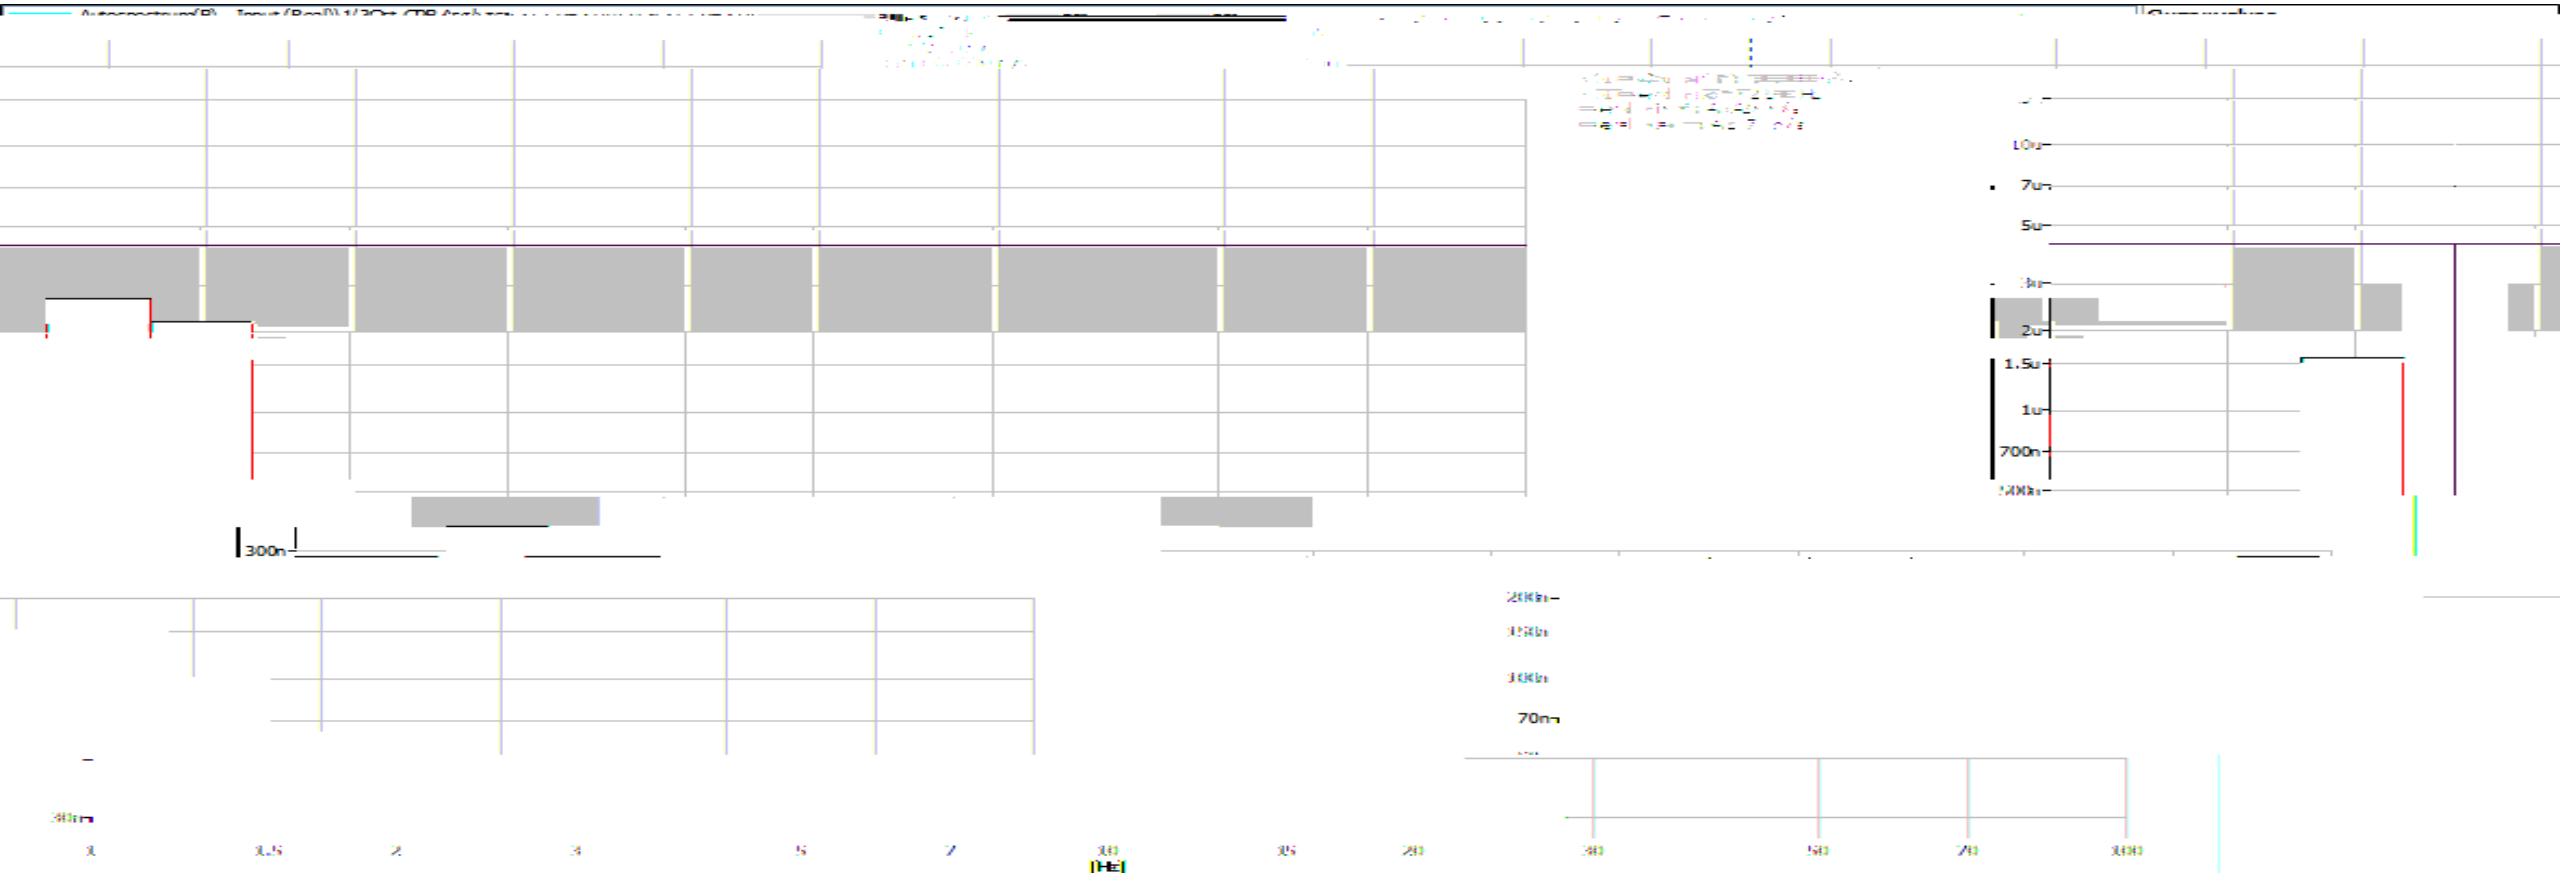

5 B

12. Y

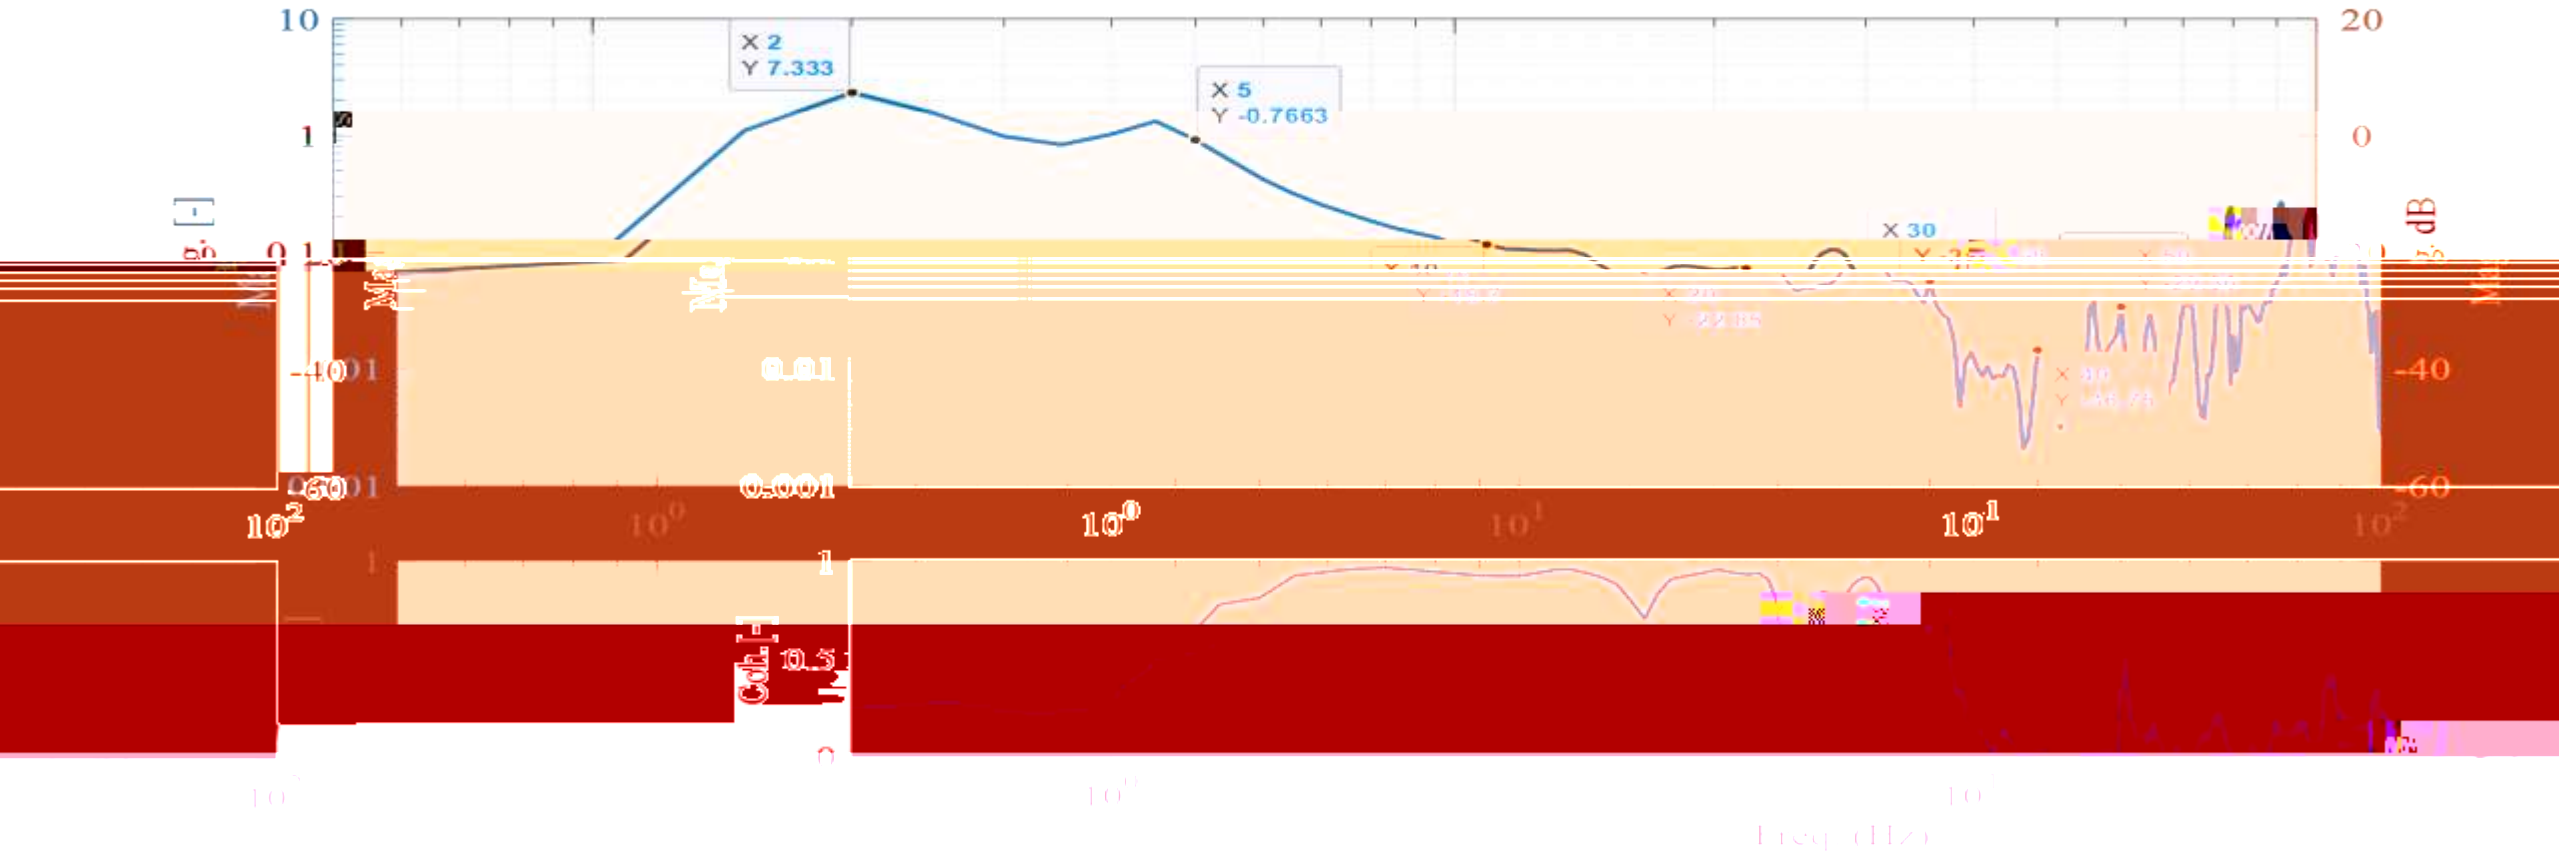
X 2
Y 7.333
X 5
Y -0.7663
X 30
10
1
0.1
20
0
-40
-60
0.01
0.001
Coh [-]
0.5
dB
Freq [Hz]

13

1. VC-E 2.063um/s 2.4 , VC-D, 4.217um/s 2.5
2. 2Hz, 5Hz 10Hz -18.7dB 20Hz -22.85dB 30Hz -24.98dB 40Hz -36.75dB 50Hz -29.36dB
3. Y @10Hz 85% @10Hz :210.100nm/s 27.292nm/s



官方网址：www.thans-cn.com
全球服务热线：+86 755-27396595



THANKS